



COLPHARMA®

AntiAcari

B E D

Acaricida a Ultrasuoni
per Materasso


10728

IT

DE

FR

Fig. 1 / Abb. 1

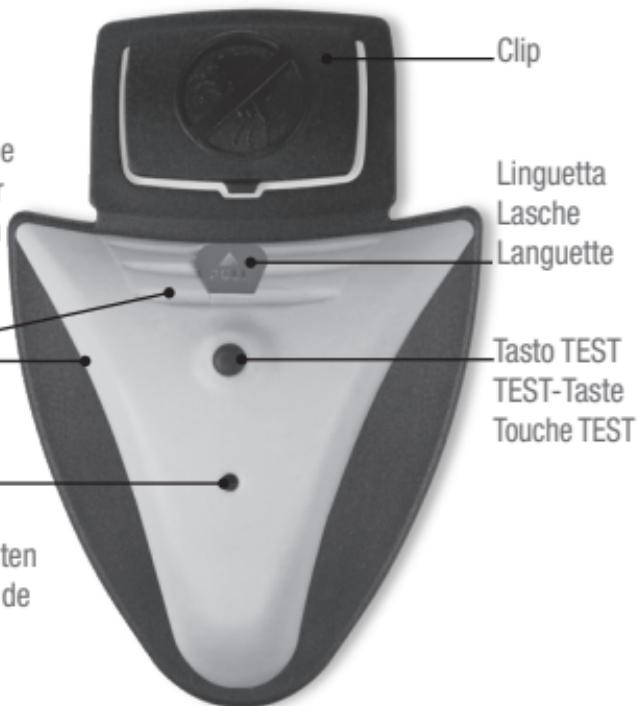

Manuale d'Uso



Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

INFORMAZIONI IMPORTANTI - AVVERTENZE

- Questo dispositivo deve essere usato esclusivamente come descritto in questo manuale. Il produttore/distributore non potrà essere ritenuto responsabile di danni derivanti da un utilizzo improprio.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali a meno che non siano controllati da una persona adulta responsabile della loro sicurezza.

LA TECNOLOGIA A EMISSIONI ULTRASONICHE

Le emissioni acaricide a ultrasuoni (onde sonore ad altissima frequenza) utilizzate dai dispositivi COLPHARMA® AntiAcari vengono emesse con una gamma di frequenze intorno ai 40.000 Hz non udibili per l'orecchio umano.

Questi ultrasuoni producono un effetto di grande disturbo sugli acari, provocando una riduzione degli accoppiamenti e la diminuzione dell'appetito, ottenendo una diminuzione significativa sia della popolazione di acari sia degli escrementi allergizzanti.

L'emissione controllata dei dispositivi COLPHARMA® AntiAcari è totalmente sicura per bambini, donne in gravidanza, soggetti allergici/asmatici, portatori di pacemaker o di altri apparecchi elettronici e animali domestici.

COME UTILIZZARE IL DISPOSITIVO

- Sfilare la linguetta (fig.1) per attivare la batteria al litio inserita.
- Cinque lampeggi indicano l'accensione del dispositivo.
- Una volta attivata la batteria, per sapere se sta ancora funzionando, premere il tasto e verificare che il led lampeggi ancora.

Agganciare l'apposita clip (colore nero) all'areatore, alle maniglie del materasso o dove possibile, con lo scudo colorato rivolto verso l'esterno. Lo scudo è provvisto di apposite fessure che convogliano in modo ottimale per tutto il materasso le emissioni ultrasoniche acaricide.

COLPHARMA® AntiAcari BED deve essere posizionato sui lati del materasso il più vicino possibile alla testa del soggetto allergico.

COLPHARMA® AntiAcari BED è estremamente potente e può essere utilizzato anche per un letto matrimoniale.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Inserire la punta piatta di un cacciavite nell'apposita fessura sul dispositivo, fare leva o ruotare leggermente per separare le due parti in plastica (fig.2).



Fig. 2

Estrarre il circuito elettronico, sfilare la batteria dal suo alloggiamento e inserirne una nuova, rispettando la polarità (fig.3).

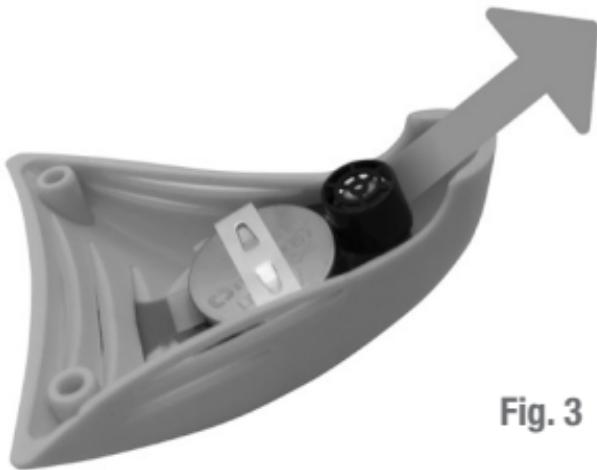


Fig. 3

Riposizionare il circuito elettronico all'interno delle due parti in plastica e premere per richiuderle (fig.4).



Fig. 4

CURA DEL DISPOSITIVO

Pulizia

Non bagnare o lavare con acqua o altri liquidi il dispositivo.
Utilizzare solo un panno morbido e asciutto.

Conservazione

Proteggere il dispositivo da:

- temperature estreme
- urti e cadute
- contaminazione e polvere

Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.



Il dispositivo deve essere smaltito in conformità alle normative locali e non con i rifiuti domestici.

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di esercizio: 5 - 50 °C / 95 % umidità relativa

Temperatura di stoccaggio: 0 - 60 °C / 15 - 95 % umidità relativa

Peso: 24 g

Dimensioni: 9,4 x 6,3 x 4,4 cm

Alimentazione: 1 x batteria litio 3CR2032 (inclusa)

Durata Batteria: 10 mesi

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

GARANZIA

Questo dispositivo è coperto da una garanzia di 5 anni dalla data di acquisto, per difetti di fabbricazione, valida solo dietro presentazione della ricevuta di acquisto. La garanzia non copre danni accidentali causati da uso improprio o da inosservanza delle istruzioni per l'uso.

AntiAcar**I** B E D

Ultraschall-Milbenbekämpfung für Matratze

DE

Bedienungsanleitung



Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung aufmerksam lesen.

WICHTIGE INFORMATIONEN - HINWEISE

- Dieses Gerät darf nur so benutzt werden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Der Hersteller/Händler ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch eine bestimmungswidrige Benutzung entstehen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

DIE TECHNOLOGIE DER ULTRASCHALL-EMISSION

Die Ultraschallemissionen (Schallwelle mit sehr hoher Frequenz) zum Schutz gegen Milben, die von den Vorrichtungen COLPHARMA® AntiAcari verwendet werden, werden im Frequenzbereich von ca. 40.000 Hz ausgegeben und sind für das menschliche Ohr nicht hörbar.

Dieser Ultraschall verfügt über eine sehr störende Wirkung auf Milben und er führt zu einer Verringerung ihrer Fortpflanzung und ihres Appetits, wodurch eine deutliche Verringerung sowohl der Population, als auch der Allergien verursachenden Ausscheidungen erzielt wird.

Die kontrollierte Emission der Vorrichtungen COLPHARMA® AntiAcari ist vollkommen sicher für Kinder, Schwangere Allergiker/Asthmatiker, Personen mit Herzschrittmacher, sonstige elektronische Geräte sowie Haustiere.

BENUTZUNG DER VORRICHTUNG

- Die Lasche herausziehen (Abb.1), um die eingesetzte Lithiumbatterie zu aktivieren.
- Ein fünfmaliges Blinken zeigt die Aktivierung der Vorrichtung an.
- Nach der Aktivierung der Batterie die Taste drücken und überprüfen, ob die LED noch blinkt, um zu überprüfen, ob die Vorrichtung noch eingeschaltet ist.

Den entsprechenden (schwarzen) Clip den Lüftungsöffnungen, den Griffen der Matratze oder wo möglich mit dem farbigem Schild nach außen anbringen. Der Schild weist Schlitze auf, die die Ultraschallemissionen gegen Milben für die gesamte Matratze in optimaler Weise abstrahlt.

COLPHARMA® AntiAcari BED muss an den Seiten der Matratze möglichst nahe am Kopf des Allergikers angebracht werden.

COLPHARMA® AntiAcari BED ist extrem leistungsstark und kann auch für ein Doppelbett eingesetzt werden.

AUSTAUSCH DER BATTERIE

Die flache Spitze eines Schraubendrehers in den Schlitz des Gerätes stecken, eine Hebelwirkung ausüben oder sie leicht drehen, um die beiden Kunststoffteile zu trennen (Abb.2).



Abb. 2

Die elektronische Schaltung herausziehen, die Batterie aus dem Gehäuse nehmen und eine neue einsetzen, wobei auf die Polarität zu achten ist (Abb.3).



Abb. 3

Die elektronische Schaltung wieder in die beiden Kunststoffteile einsetzen und auf sie drücken, um sie wieder zu schließen (Abb.4).



Abb. 4

PFLEGE DES GERÄTS

Reinigung

Das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten anfeuchten oder waschen. Nur ein weiches und trockenes Tuch verwenden.

Aufbewahrung

Schützen Sie das Gerät vor:

- extremen Temperaturen
- Stoß und Fall
- Verschmutzung und Staub

Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.



Entsorgen Sie das Gerät gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Es darf nicht in den Hausmüll kommen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur:	5 - 50 °C / 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Aufbewahrungstemperatur:	0 - 60 °C / 15 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht:	24 g
Maße:	9,4 x 6,3 x 4,4 cm
Spannungsquelle:	1 Lithium-Batterie 3CR2032 (liegt Packung bei)
Haltbarkeit der Batterie:	10 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

GARANTIE

Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 5 Jahren ab dem Kaufdatum für Fabrikationsfehler, die nur bei Vorlage der Kaufquittung gültig ist. Die Garantie deckt keine Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.

Manuel d'utilisation



Lisez attentivement ce manuel
avant l'utilisation.

INFORMATIONS IMPORTANTES - AVERTISSEMENTS

- Ce dispositif doit être utilisé exclusivement de la manière décrite dans ce manuel. Le producteur/distributeur ne sera pas tenu pour responsable des dommages dérivant d'une utilisation impropre.
- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf sous le contrôle d'une personne adulte responsable de leur sécurité.

LA TECHNOLOGIE À ÉMISSION D'ULTRASONS

Les émissions d'acaricides à ultrasons (ondes sonores à très haute fréquence) utilisées par les appareils COLPHARMA® AntiAcari sont émises dans une gamme de fréquences d'environ 40 000 Hz inaudibles pour l'oreille humaine.

Ces ultrasons ont un effet fortement perturbateur sur les acariens, entraînant une réduction des accouplements et de l'appétit, réduisant ainsi de façon significative la population d'acariens et des excréments allergéniques.

L'émission contrôlée des appareils COLPHARMA® AntiAcari est totalement sûre pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes allergiques/asthmatiques, les porteurs de stimulateurs cardiaques et autres appareils électroniques ainsi que les animaux domestiques.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

- Extraire la languette (fig.1) pour activer la pile au lithium.
- Cinq clignotements indiquent que l'appareil est allumé.
- Une fois que la pile est activée, pour s'assurer qu'elle fonctionne encore, appuyer sur la touche et vérifier que le voyant clignote toujours.

Fixer le clip (de couleur noire) sur l'aérateur, aux poignées du matelas ou ailleurs, en orientant l'écran coloré vers l'extérieur. L'écran est équipé de fentes spéciales qui transmettent de manière optimale les émissions à ultrasons acaricides à travers tout le matelas.

COLPHARMA® AntiAcari BED doit être placé sur les côtés du matelas le plus près possible de la tête de la personne allergique.

COLPHARMA® AntiAcari BED est extrêmement puissant et peut également être utilisé pour un lit double.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

Placez la pointe d'un tournevis dans la fente prévue sur le dispositif, faites levier ou tournez légèrement pour séparer les deux parties en plastique (fig.2).



Fig. 2

Sortez le circuit électronique, retirez la pile de son siège et en mettre une neuve, en respectant la polarité (fig.3).

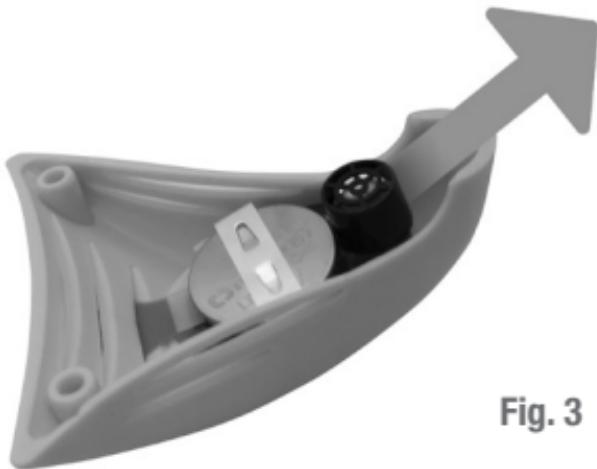


Fig. 3

Remettez en place le circuit électronique à l'intérieur des deux parties en plastique et appuyez pour les refermer (fig.4).



Fig. 4

ENTRETIEN DU DISPOSITIF

Nettoyage

Ne pas mouiller ou laver le dispositif à l'eau ou avec d'autres liquides. Utilisez uniquement un chiffon souple et sec.

Conservation

Protégez le dispositif en évitant de l'exposer :

- aux températures extrêmes
- aux chocs et chutes
- à la contamination et à la poussière

Conservez le dispositif dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité.



Le dispositif doit être mis à la décharge conformément aux normes locales et pas comme déchet domestique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température de service : 5 - 50 °C / 95 % humidité relative

Température de stockage : 0 - 60 °C / 15 - 95 % humidité relative

Poids : 24 g

Dimensions : 9,4 x 6,3 x 4,4 cm

Alimentation : 1 x pile lithium 3CR2032
(incluse)

Durée Pile : 10 mois

Sous réserve d'apporter des modifications techniques.

GARANTIE

Ce dispositif est couvert par une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat, contre les défauts de fabrication, valable uniquement sur présentation du reçu d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels provoqués par un usage impropre ou la non-observation du mode d'emploi.

COLPHARMA®
Colpharma s.r.l.
Parma - Italy
www.colpharma.com

 SAVIFIN SRL

Via Volta, 34 - 20825 Barlassina (MB)

 Numero Verde
800-510661
SERVIZIO CONSUMATORI



Cod. 10728